ageLOC®

WellSpa iO

ageLOC 新智清体仪 iO

使用手册

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管。

目录

ageLOC新智清体仪iO组件 1-2

安全指南、警示信息与注意事项 3-4

仪器存放 5

仪器充电 6

联机指引 7

操作指南 8-9

仪器清洁和养护 10

故障排除 11

更换和售后条款 13

仪器技术规格 14

符号标识 14

免责声明 16

ageLOC新智清体仪iO组件

简易操作指南

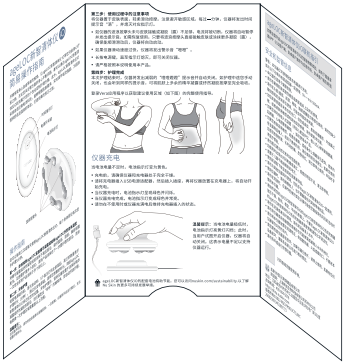

ageLOC新智清体仪iO

ageLOC新智清体仪iO无线充电器

*不包含USB电源适配器

ageLOC新智清体仪iO组件

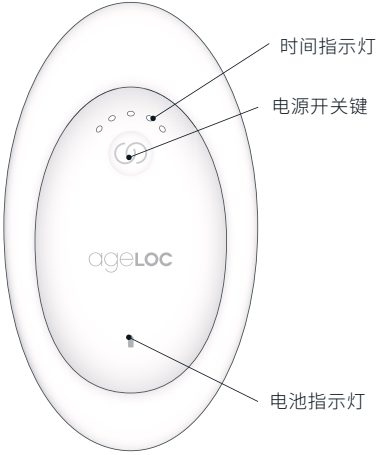

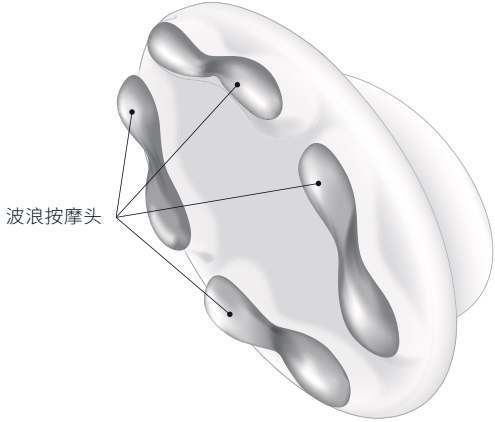

*注意：图示仅为参考，非实际尺寸

安全指南、警示信息与注意事项

ageLOC新智清体仪iO和无线充电器经过海拔4千米的压力测试。
本仪器电池不可更换。

⚠ 警告

警告：本仪器仅可使用配套充电器进行充电。

- 本仪器仅适用于健康皮肤。
- 请勿在头部/面部、前颈、喉咙、胸部或腹股沟等部位使用。请勿在缺少敏锐感知的身体部位使用，可能会导致异常刺激。
- 如您皮肤表面有未愈合的伤口、创伤或皮疹、患有玫瑰糠疹、对金属过敏，或者皮肤易敏感或有其他皮肤疾病，请勿使用本仪器。
- 请勿在肿胀、发红、感染或发炎的部位使用；请勿在皮肤病患处（例如静脉炎、血栓性静脉炎、静脉曲张等）的区域使用。
- 请勿在癌性病变或病变组织上及附近使用。
- 使用仪器时，请勿触摸他人，也不要触碰任何其他带电物品。
- 请勿超过建议频次和时间范围使用。
- 请勿在洗澡或淋浴时使用。请勿将仪器浸入水中。
- 如果您体内有植入式装置（例如心脏监护仪、植入式心律转复除颤器、起搏器、心电图警报器等），请勿使用本产品!
- 如果您皮肤容易敏感，或患有癫痫，或有身体上佩戴穿孔配饰、或体内有金属物品植入，或处于患病阶段，请在使用前咨询医生。如果您使用后感到皮肤刺激、长时间刺痛、皮肤发红，请立即停止使用，并及时寻求医疗帮助。
- 如果您有出血倾向、容易瘀伤、已经怀孕或正在备孕及近期有过外科手术史，请在使用前咨询医生。
- 请严格按照本使用手册使用仪器，且勿用于突起的痣或受损的肌肤。

安全指南、警示信息与注意事项

- 如果您有病史或正患有疾病，例如心脏病、中风、高血压或肝脏疾病，请在使用前咨询医生。
- 请置于儿童不易接触到的地方。
- 使用前请取下珠宝或其他金属装饰品。
- 请勿与其他仪器同时使用，包括多台ageLOC新智清体仪iO一起使用。
- ageLOC新智清体仪iO仅供个人使用。
- 充电时请务必使用ageLOC新智清体仪iO配套充电器。请勿尝试使用其他充电配件。
- 请始终将您的ageLOC新智清体仪iO和无线充电器放在干燥、耐热、稳定、平坦的表面上，尤其是在充电时。
- 请勿在不使用时或仪器充满电后维持充电器插入的状态。
- 请勿将ageLOC新智清体仪iO长时间放置在极冷的环境中。
- 请勿在ageLOC新智清体仪iO和ageLOC新智清体仪iO无线充电器表面使用刺激性化学清洁剂，也不要用坚硬的钢丝球或百洁布等的粗糙面清洁ageLOC新智清体仪iO和ageLOC新智清体仪iO无线充电器。
- 为降低电击、刺激、火灾或受伤的风险，请勿将仪器或无线充电器摆放或储存在可能掉落或被碰入水中的地方。
- 请勿将仪器摆放或储存在可能掉落或被碰入浴缸、水槽或马桶的地方。
- 请勿将本仪器放置在热源附近，例如散热器、火焰或散热口。不要将本仪器留在炎热的车内。
- 请勿在驾驶时、在操作机械时或在从事可能使您面临受伤风险的活动时使用本仪器。
- 请定期检查仪器是否损坏；如果仪器已损坏，请停止使用。如果有任何设备损坏，请联系如新公司进行相关售后。
- 请勿拆开或自行修理仪器。

仪器存放

本仪器和无线充电器理想的存放温度为室温20°C到24°C(68°F 到75°F)之间。

本仪器存放的极限温度环境为5°C~ 45°C(41°F ~ 113°F)。

如温度超出以上范围，电池、波浪按摩头和仪器运行都将受到不利影响。

如处于温度过高或炎热环境（如超过50°C/122°F 、或阳光直射、或车内温度过高时）会导致仪器过热或其他危险状况，这将严重影响本仪器的性能和使用寿命。

如处于温度过低或冷冻环境，波浪按摩头和仪器也会遭到永久性损坏。

仪器充电

- 充电前，请确保仪器和充电器处于完全干燥。
- 请将充电器插入USB电源适配器，然后插入插座，再将仪器放置在充电器上，将自动开始充电。

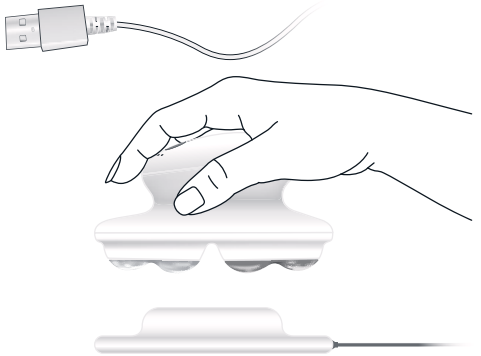

- 当仪器充电时，电池指示灯呈现绿色并闪烁。
- 当仪器充电完成，电池指示灯变成绿色并常亮。
- 请勿在不使用时或仪器充满电后维持充电器插入的状态。

温馨提示：

当电池电量极低时，电池指示灯亮黄灯闪烁；此时，当用户试图开启仪器，仪器将自动关闭。这表示电量不足以支持仪器运行。

如指示灯没有亮起，请及时充电。充电完成后，指示灯将恢复正常。

ageLOC新智清体仪iO的配套电池有助节能。您可以访问nuskin.com/sustainability.以了解 Nu Skin 的更多可持续发展举措。

联机指引

如需全面开启ageLOC新智清体仪iO的智能物联体验，请先下载星享城APP（IOS客户端、安卓客户端华为应用市场、安卓客户端应用宝），或通过扫描下方二维码进行下载。

安卓客户端

华为应用市场

安卓客户端

应用宝

IOS客户端

App Store

配对

配对前准备工作

1. 安装完成后打开星享城App，登录如新账号。
   - 如您已有如新账户，请用该账户登录。
   - 如您是新用户，只需简单注册即可。
2. 确保手机蓝牙处于开启状态，仪器处于开启状态。

开始配对

1. 点击首页“Vera”入口 >“我的产品” > 底部“+ 配对新仪器”按钮或**直接点击首页右下角“快捷配对”按钮**。
2. 点击“开始”>“ageLOC WellSpa iO”>“连接”。
3. 完成配对，即可体验智能肌肤护理之旅。

如需了解如新中国如何收集、使用和共享个人数据，请访问 https://china.nuskin.com/html/content/yinsizhengce.html

操作指南

您可以每周三次或每天使用ageLOC新智清体仪iO，每个身体部位每次至多护理5分钟。

第一步：涂抹如新ageLOC紧肤精华凝露或如新ageLOC纾然身体凝胶

将精华凝露或纾然凝胶轻轻涂抹于相应部位，避开面部、前颈、胸部和腹股沟。如想要护理多个部位，请将产品涂抹在下一步要护理的部位，而非一次性全部将产品涂抹于多个部位上。

第二步：开始护理

轻按电源键开机。首次启动时，5个指示灯将全部亮起，亮灯的数量表示护理时长（分钟）。通过点击电源键，选择您想要的时长。随后ageLOC新智清体仪iO将记住您的设置。开始护理时，请将仪器放置于涂抹好精华凝露或纾然凝胶的部位，当仪器发出“呼呼”的声音，即自动开启护理。每更换一次护理区域需重复以上流程。

温馨提示：

若需要调整护理时长，仪器开机后，请勿将波浪按摩头接触肌肤。一旦接触，仪器将开启运行模式，则无法对护理时长做出调整。

第三步：使用过程中的注意事项

将仪器置于皮肤表面，轻柔滑动按摩。注意避开敏感区域。每过一分钟，仪器将发出时间提示音“滴”，并熄灭对应指示灯。

- 如仪器的波浪按摩头未与皮肤接触或凝胶（露）不足够，电流将被切断，仪器将自动暂停并发出提示音。如需恢复使用，只要将波浪按摩头直接碰触皮肤或涂抹更多凝胶（露），确保能顺滑滑动后，仪器将自动启动。
- 如果仪器滑动速度过快，仪器将发出警示音“噔噔”。
- 长按电源键，直至指示灯熄灭，即可关闭仪器。
- 请严格按照本说明使用本产品。

第四步：护理完成

本次护理结束时，仪器将发出减弱的“噔噔蹬蹬”提示音并自动关闭。如护理中途您手动关闭，也会听到同样的提示音，可将肌肤上多余的精华凝露或纾然凝胶按摩至完全吸收。

登录Vera应用程序以获取建议使用区域（如下图）的完整使用指导。



清洁和养护

请在每次使用之后，用微湿的无绒湿巾擦净波浪按摩头和无线充电器上残留的精华凝露/纾然凝胶。将清洁完的ageLOC新智清体仪iO放置于阴凉干燥处，并用干燥的无绒湿巾彻底擦干波浪按摩头和无线充电器的外表面。请勿将仪器浸入水或任何液体中。

故障排除

使用过程中断电

如波浪按摩头未与皮肤接触，电流将被切断，仪器将自动暂停；同时仪器发出提示音，指示灯闪烁。

温馨提示：

精华凝露或纾然凝胶用量不足时，可能影响导电性，请增加精华凝露或纾然凝胶用量，并确保按摩头与涂抹精华凝露或纾然凝胶的皮肤充分接触，以达到最佳效果。

使用过程中对移动速度的提示

如果护理时滑动移动过快，仪器将发出警示音。当滑动速度降低至正常时，程序即自动恢复。为了获得更好的使用效果，请在皮肤上缓慢滑动仪器，或打圈按摩。

重新连接蓝牙设置

如您在与Vera 配对时遇到问题，或需要解除与手机的配对，请重新设置蓝牙连接。

1. 请找到“设置” >“忽略此仪器”，断开与Vera的连接。
   点击Vera程序内设置图标 ⚙
2. 断开手机连接
   - **苹果手机：**点击手机的“设置” >“蓝牙” >，找到“我的设备”中对应的仪器，点击 ⓘ > 点击“忽略此设备”。
   - **安卓手机：**点击手机的“设置” >“蓝牙” >，找到“已配对的设备”中对应的仪器，点击 ⚙ > 点击“取消配对”。
3. 将ageLOC新智清体仪iO放置在充电器上
4. 长按电源键5秒，请等待：时间指示灯快速闪烁熄灭。

恢复出厂设置

1. 请找到“设置” >“忽略此仪器”，断开与Vera的连接。点击Vera程序内设置图标 ⚙
2. 断开手机连接
   - **苹果手机：**点击手机的“设置” >“蓝牙” >，找到“我的设备”中对应的仪器，点击 ⓘ > 点击“忽略此设备”。
   - **安卓手机：**点击手机的“设置” >“蓝牙” >，找到“已配对的设备”中对应的仪器，点击 ⚙ > 点击“取消配对”。
3. 将ageLOC新智清体仪iO放置在充电器上
4. 长按电源键10秒，请等待：时间指示灯快速闪烁熄灭，继续按住，直到指示灯再次快速闪烁三次。

注意事项

ageLOC新智清体仪iO将自动储存产品质量和使用信息。当本仪器恢复出厂设置后，部分关于仪器的使用数据将被保存，用于提升产品质量。如需查看如新中国隐私政策，请访问：-https://china.nuskin.com/html/content/yinsizhengce.html

废弃处理

请根据当地法律法规正确处理回收ageLOC新智清体仪iO。ageLOC新智清体仪iO内含电子元件和锂离子电池，因此需与日常生活垃圾分类处理。当ageLOC新智清体仪iO无法使用后，烦请联系当地垃圾分类管理部门。根据当地垃圾分类管理条例正确进行处理和回收。

为了您的生活环境请妥善处理电池

日常保养

参见“清洁和养护”所述的日常保养方法。

请勿空运已损坏的仪器。

仪器售后

请勿尝试自行拆开或修理仪器，否则任何售后条款将失效。本仪器中无任何可由用户自行维修的零部件。具体售后条款请参阅“更换和售后条款”的服务内容。

更换和售后条款

1. 售后标的：ageLOC新智清体仪iO、ageLOC新智清体仪iO无线充电器
2. 售后期间：ageLOC新智清体仪iO、ageLOC新智清体仪iO无线充电器自购买日*起算1年内，因产品质量原因而造成的损坏或故障，享受无偿售后服务，但需出示ageLOC新智清体仪iO的购货单据正本（如已开具发票请同时出示发票）。单据上显示的资料需与仪器身编码相符方可售后（机身码位于仪器底部）。售后服务中更换下来的零件，均不交还用户。
3. 若产品之故障或损坏由下列原因所引起者，恕不提供无偿售后服务：
   - 用户使用、保管不当（如摔落仪器）或擅自变更外观零件或自行拆卸致使仪器不能正常使用者；
   - 未依照本产品使用手册的指示操作所引起的问题；
   - 因天灾或其他非可归责于本公司之人为因素所造成者（包括运输时之损坏等）；
   - 产品机身编码被更改、被除去或与购货单据不相符者；
   - 仪器外壳的破损及自然老化；
   - 由非经本公司授权之第三方进行维修或保养；
   - 使用非本公司认可之其他厂牌零配件；
   - 无有效购货单据者，可以实行收费维修（不含海外机）。
4. 售后路径：打开星享城APP，进入右下角“我的”页面，点击“仪器售后”，按流程指示完成操作**。

*购买日是指从官方线上购买渠道购买后快递签收的日期，或者在如新店铺购买该产品的日期
**如有疑问，请拨打400-004-5678*1进行咨询。

仪器技术规格

ageLOC新智清体仪

产品型号：BS2R

最大输出电流：640μA

额定输出：22V,640μA,0.414Hz

IPX5　IPX7

ageLOC新智清体仪无线充电器

产品型号：BS2RCA

输入：5V ⎓ 500mA

IPX4

符号标识

符号标识	释义定义
	警告
	为了您的生活环境 请妥善处理电池
	三类设备
	使用特定的充电装置
	直流电

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
硅胶件	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
线路板及组件	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
胶水及泡棉粘胶垫	○	○	○	○	○	○
螺丝及连接线	○	○	○	○	○	○
电镀件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

表中标有“×”的所有部件均符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》要求。

请注意，因型号不同，并非上述所有部件都包含在销售产品包装中。

本产品的环保使用期限为10年。

电池部分的环保使用期限为5年。

环保使用期限的参考标准，取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

免责声明

在任何情况下如新（中国）日用保健品有限公司、员工及股东均不会对于您或者其他人士因使用本产品所受之非直接损害承担损害赔偿或惩罚性赔偿责任。

如新(中国)日用保健品有限公司
制造商：上海新如生物科技有限公司苏州分公司
地址：江苏省苏州市苏州工业园区华正街1号3号厂房101室
产品标准号：GB 4706.1 GB 4706.10
生产批号：见包装标示
产地：江苏省苏州市 合格
咨询热线：400-004-5678
http://china.nuskin.com
版权所有©2023 NSE PRODUCTS,INC
29002589 94517003/1